



آزمایشگاه مرجع سلامت

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

معاونت سلامت

آزمایشگاه مرجع سلامت

اداره مدیریت آزمایشگاه‌های بهداشتی

دستورالعمل نمونه گیری و تشخیص آزمایشگاهی

ویبریو کلرا

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی



آزمایشگاه مرجع سلامت

## دستورالعمل تهیه نمونه رکتال سوآب

- ۱- محیط کشت کری بLER را طبق دستور شرکت سازنده تهیه و در لوله های در پیچ دار می ریزیم به طوری که ارتفاع آن حدود ۴-۵ سانتی متر باشد.
- ۲- یک عدد سوآب رکتال را با فرو کردن در محیط انتقالی مرطوب نموده و حدود ۳-۴ سانتی متر داخل اسفنکتر رکتوم فرو برد و با یک حالت دورانی ۳۶۰ درجه می چرخانیم.
- ۳- سوآب را بیرون کشیده ، نگاه می کنیم تا مطمئن شویم که سوآب به مدفوع آغشته شده باشد.
- ۴- سوآب را داخل محیط کری بLER می برمیم به طوری که حدود ۴ سانتی متر در داخل محیط انتقالی فرو رود ، سپس اضافه سوآب را می شکنیم به طوری که درب لوله به راحتی بسته شود.
- ۵- سوآب را به همراه مشخصات کامل بیمار شامل نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن و جنس ، زمان شروع علائم ، آدرس و تلفن بیمار در کوتاهترین زمان ممکن به نزدیکترین آزمایشگاه انجام دهنده کشت التور ارسال می نماییم.
- ۶- در صورت عدم امکان ارسال در زمان نمونه گیری ، لوله را تا زمان ارسال در یخچال (۲-۸ درجه سانتی گراد) نگهداری می کنیم.

آدرس : خیابان حافظ ، نرسیده به جمهوری ، کوچه زرتشیان ، کوچه محمد بیک ، پلاک ۴۸ ، طبقه دوم ، آزمایشگاه مرجع سلامت  
Tel : ۰۶۷۲۸۱۱۲ Fax : ۰۶۷۲۸۱۱۳-۰۶۷۲۸۱۲۱-۰۶۷۲۸۱۲۳-۰۶۷۲۳۳۴۶



## دستورالعمل تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا

۱- سوآب رکتال منتقل شده به آزمایشگاه (که در محیط کری بلر قرار داده شده) را بلا فاصله روی محیط TCBS اول، کشت دهید و به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمای ۳۵-۳۷ درجه سانتیگراد گرم‌گذاری (انکوبه) کنید. سپس سوآب را وارد محیط آب پیتوونه قلیابی (Alkaline Peptone Water)APW نموده پس از ۶-۸ ساعت گرم‌گذاری (انکوباسیون) در دمای ۳۵-۳۷ درجه سانتیگراد، از سطح و بالاترین بخش محیط برداشت نموده در محیط TCBS دوم کشت دهید.

- توجه: از زمان تهیه محیط TCBS نباید بیش از یک هفته گذشته باشد. همچنین محیط‌های TCBS باید در کیسه‌های فریزر در بسته در یخچال نگهداری شوند.

- توجه: باید مقدار نمونه نسبت به حجم محیط رعایت شود. یک عدد رکتال سوآب در ۲ml محیط APW تلقیح شود.

۲- اگر نمونه آب پیتوونه قلیابی APW را نتوان پس از ۶-۸ ساعت انکوباسیون به TCBS منتقل کرد، تا ۱۸ ساعت صبر کنید سپس نمونه را به داخل لوله تازه محتوی آب پیتوونه قلیابی APW ببرید؛ ۶-۸ ساعت انکوبه نموده و سپس روی محیط TCBS کشت دهید.

۳- پس از مدت زمان انکوباسیون در صورت مشاهده کلنجی های صاف، زرد نگ و براق به قطر ۲-۴ میلی متر در محیط TCBS، کلنجی را در محیط KIA کشت داده به مدت ۱۸-۲۴ ساعت در دمای ۳۵-۳۷ درجه سانتی گراد گرم‌گذاری نمایید.

- توجه: محیط KIA باید به عمق ۳cm و سطح ۳cm ساخته شود.

- توجه: اگر جهت تهیه محیط KIA از لوله در پیچ دار استفاده می کنید، هنگام انکوباسیون درب لوله را شل کنید که امکان تهییه هوا در لوله وجود داشته باشد.


۴- در صورت مشاهده واکنش alk/acid بدون گاز، تست اکسیداز را انجام دهید.

- توجه: جهت انجام تست اکسیداز از کلنجی‌های رشد کرده بر روی محیط TCBS استفاده نکنید زیرا ممکن است نتایج مثبت یا منفی کاذب در پی داشته باشد.

- روش انجام تست اکسیداز:

دو تا سه قطره از معرف اکسیداز را روی تکه ای کاغذ صافی در پتري دیش قرار دهید. کشت را با لوب پلاتینی یا اپلیکاتور چوبی در سرتا سر کاغذ مرتبط بگسترانید. در واکنش مثبت، باکتری بی درنگ به رنگ ارغوانی تیره در می آید. ارگانیسم های اکسیداز منفی بی رنگ می مانند یا پس از ۱۰ ثانیه به رنگ ارغوانی در می آینند. در صورتی که دیسک اکسیداز آماده « تترا متیل پارا فنیلن دی آمین دی هیدرو کلرید» (تجارتی) با باکتریهای مشخص اکسیداز مثبت و اکسیداز منفی کنترل کیفیت شده باشد، می توان از آن استفاده کرد.

ادرس: خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، کوچه رزتشتیان، پلاک ۴۸، طبقه دوم، آزمایشگاه مرجع سلامت Tel: ۰۵۲۶-۶۶۷۲۳۳۴۶-۶۶۷۲۸۱۲۱-۶۶۷۲۸۱۱۳ Fax: ۰۵۲۶-۶۶۷۲۸۱۲۱



- توجه: برای قرائت نتیجه واکنش اکسیداز باید زمان مناسب (کمتر از + ۱ ثانیه) رعایت شود.
- روش ساخت معرف اکسیداز:

تترا متیل پارا فنیلن دی آمین دهیدرو کلرید: ۰/۰۵ گرم، آب مقطر: ۵ سی سی

معرف را در آب مقطر حل کنید (برای حل کردن گرما ندهید).

- توجه: هر بار که معرف تهیه می شود باید با شاهدهای مثبت و منفی کنترول کیفیت شود.
- توجه: محلول اکسیداز باید هر روز، تازه تهیه شود و قابل نگهداری نمی باشد.

۵- در صورت مثبت بودن تست اکسیداز مراحل زیر را انجام دهید. (با توجه به جدول ضمیمه)

۶- باکتری را روی محیط SIM کشت دهید که در صورت مثبت بودن واکنشهای ذیل مشاهده می شوند:

SH2 : منفی -

ا، ایندول: مثبت -

Motility : مثبت -

- توجه: تست ایندول را با استفاده از محیط APW نیز می توان انجام داد.

۷- انجام تستهای سرولوژی:

- توجه: قبل از انجام تستهای سرولوژی با آنتی سرمها لازم است حتماً تست اتو آگلوتیناسیون انجام شود:

بخشی از کلنی رشد کرده بر روی محیط KIA یا SIM را برداشت کرده در یک قطره سرم فیزیولوژی بر روی لام شیشه ای خوب مخلوط کنید. سپس لام را به مدت ۱ دقیقه به جلو و عقب تکان دهید تا مطمئن شوید آگلوتیناسیون خودبه خودی صورت نگرفته است. اگر آگلوتیناسیون خود به خودی رخ دهد، در این صورت باکتری rough است و نمی توان سروتیپ آن را تعیین کرد.

الف) بررسی با آنتی سرم پلی والان 01 :

اگر نتیجه مثبت شد: با آنتی سرم تک ظرفیتی اوگاوا- اینابا بررسی نمایید.

اگر نتیجه منفی شد: در صورت شک به اپیدمی سوش 0139 با آنتی سرم تک ظرفیتی 0139 بررسی نمایید.

- توجه: جهت انجام تستهای سرولوژی ضروری است از کلنی های تازه که در محیط KIA یا SIM و شد کرده اند استفاده نموده و از کلنیهای موجود در محیط TCBS/استفاده نشود.

آدرس: خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، کوچه زرتستان، کوچه محمد بیک، پلاک ۴۸، طبقه دوم، آزمایشگاه مرجع سلامت Tel: ۰۵۲۶-۶۶۷۲۳۳۴۶-۶۶۷۲۸۱۲۱-۶۶۷۲۸۱۱۳ Fax: ۰۵۲۶-۶۶۷۲۸۱۲۱



۹- کشت روی محیط مولر هیلتون و انجام آنتی بیوگرام

- دیسکهای مورد استفاده در تست آنتی بیوگرام:

فورازولیدون(Fr) - آمبی سیلین(Am) - کوتربیوموکسازول(SXT) - نالیدیکسیک اسید(NA) - سپروفلوکساسین(CIP)


تتراسایکلین(Te)

۱۰- پس از انجام مراحل فوق ضروری است نمونه ها نگهداری شده تا در مراحل بعدی جهت انجام ژنوتایپ منتقل شوند. جهت نگهداری باکتری به مدت حدود یک ماه از محیط(Trypticase Soy Agar)TSA در یخچال، استفاده نموده و برای نگهداری به مدت طولانی تر می توان نمونه را در محیط(Trypticase Soy Broth)TSB ۱۰-۱۵٪ گلیسرول، کشت داده، در فریزر منفی ۷ درجه سانتی گراد نگهداری نمود.

۱۱- برای انتقال موارد مثبت به آزمایشگاه مرجع کشوری تأثید تشخیص، نمونه رشد کرده در محیط KIA با رعایت اصول ایمنی و شرایط استاندارد بسته بندی<sup>\*</sup>، ارسال شود. از ارسال نمونه های مدفوع یا سوآب رکتال به آزمایشگاه مرجع کشوری خودداری نمایید.


\* توجه: جهت رعایت اصول ایمنی و شرایط استاندارد بسته بندی، ترجیحاً محیط KIA باید در لوله درپیچ دار غیرقابل نفوذ به مایعات ساخته شود. در غیر اینصورت درب لوله KIA را با پارافیلم کامل<sup>\*</sup> بسته و آن را در محفظه پلاستیکی مقاوم درپیچ دار قرار داده و اطراف آن را ماده جاذب الرطوبه ای مانند تکه های ابر بگذارید که لوله تکان نخورد. سپس آن را در داخل cold box قرار دهید. برای راهنمایی می توانید از شکل ضمیمه استفاده کنید.





آژانس ممنوع سازمان

## راهنمای انتقال نمونه

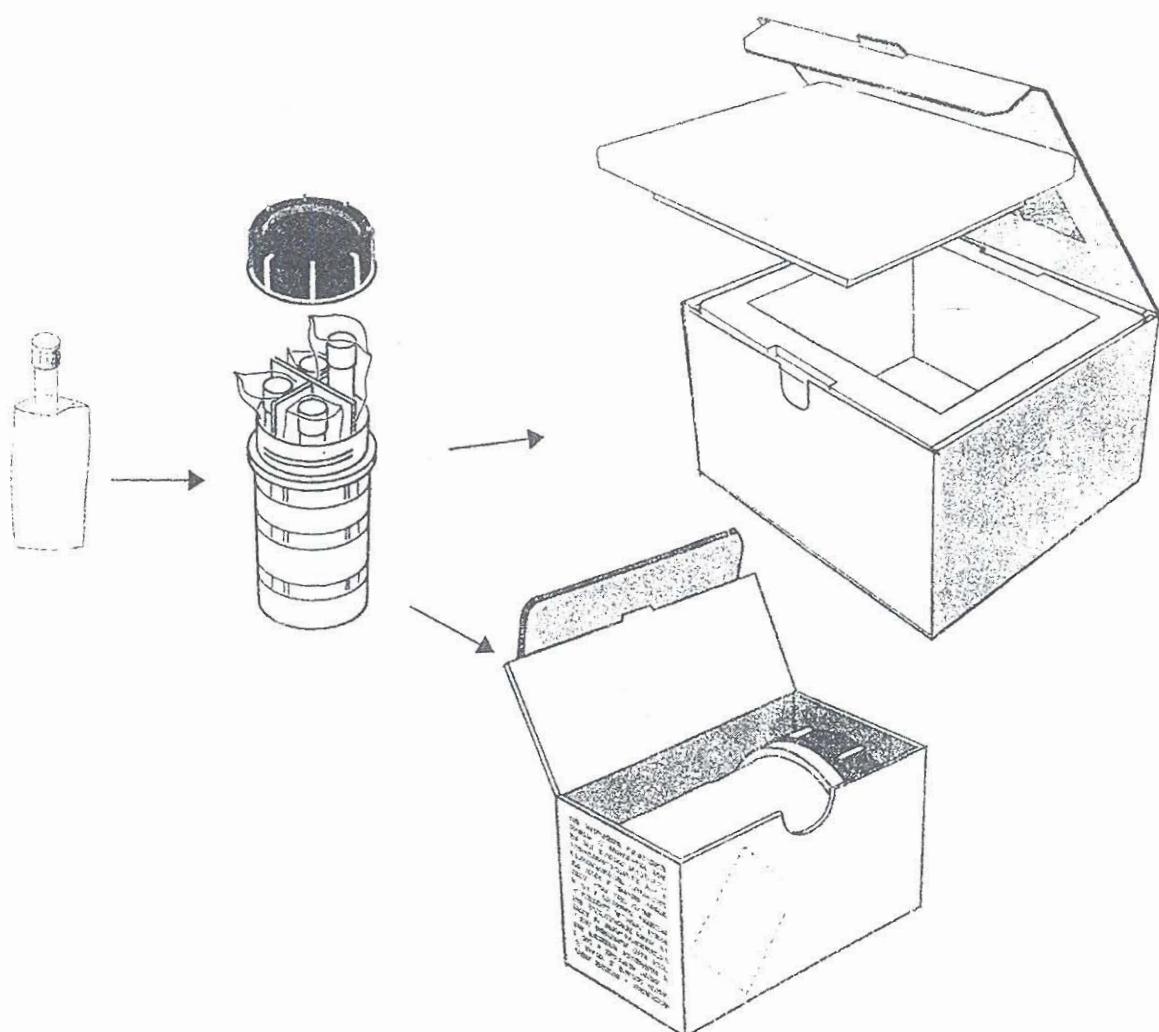



## جدول

## خصوصیات افتراقی باسیلهای گرم منفی تخمیری اکسیداز مثبت

| CHARACTERISTIC                                     | AEROMONAS HYDROPHILIA | PLESIOMONAS SHIGELLOIDES | CHROMOBACTERIUM VIOLACEUM | VIBRIO CHOLERAE |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kligler iron agar<br>(slant/deep/hydrogen sulfide) | K/A/-                 | K-A/A/-                  | K/A/-                     | K/A/-           |
| Catalase   | +                     | +                        | +                         | +               |
| Esculin  | +                     | -                        | -                         | -               |
| Motility   | +                     | +                        | +                         | +               |
| ONPG   | +                     | +                        | -                         | +               |
| Indole   | +                     | +                        | -                         | +               |
| Voges-Proskauer                                    | (+)                   | -                        | -                         | (-)             |
| Lysine decarboxylase                               | +                     | +                        | -                         | +               |
| Ornithine decarboxylase                            | -                     | +                        | -                         | +               |
| Carbohydrate:                                      |                       |                          |                           |                 |
| Lactose  | (-)                   | (+)                      | -                         | -               |
| Sucrose  | +                     | -                        | (-)                       | +               |
| Manitole   | +                     | -                        | -                         | +               |
| Inositol   | -                     | +                        | -                         | -               |
| Growth in Peptone, 1% with:                        |                       |                          |                           |                 |
| 0% NaCL  | +                     | +                        | +                         | +               |
| 7% NaCL  | -                     | -                        | -                         | -               |
| 11% NaCL   | -                     | -                        | -                         | -               |

+: 90% or more of strains are positive


(+) : 51% - 89% of strains are positive

(-) : 10% - 50% of strains are positive


- : less than 10% of strains are positive

آدرس: خیابان حافظ، نرسیده به جمهوری، کوچه زرتشیان، کوچه محمد بیک، پلاک ۴۸، طبقه دوم، آزمایشگاه مرجع سلامت  
Tel : ۰۶۷۶-۰۵۲۶-۶۶۷۲۳۳۴۶-۶۶۷۲۸۱۱۳-۶۶۷۲۸۱۱۲ Fax : ۰۶۷۶-۰۵۲۶-۶۶۷۲۸۱۱۲

## Flow chart of cholera testing in laboratory

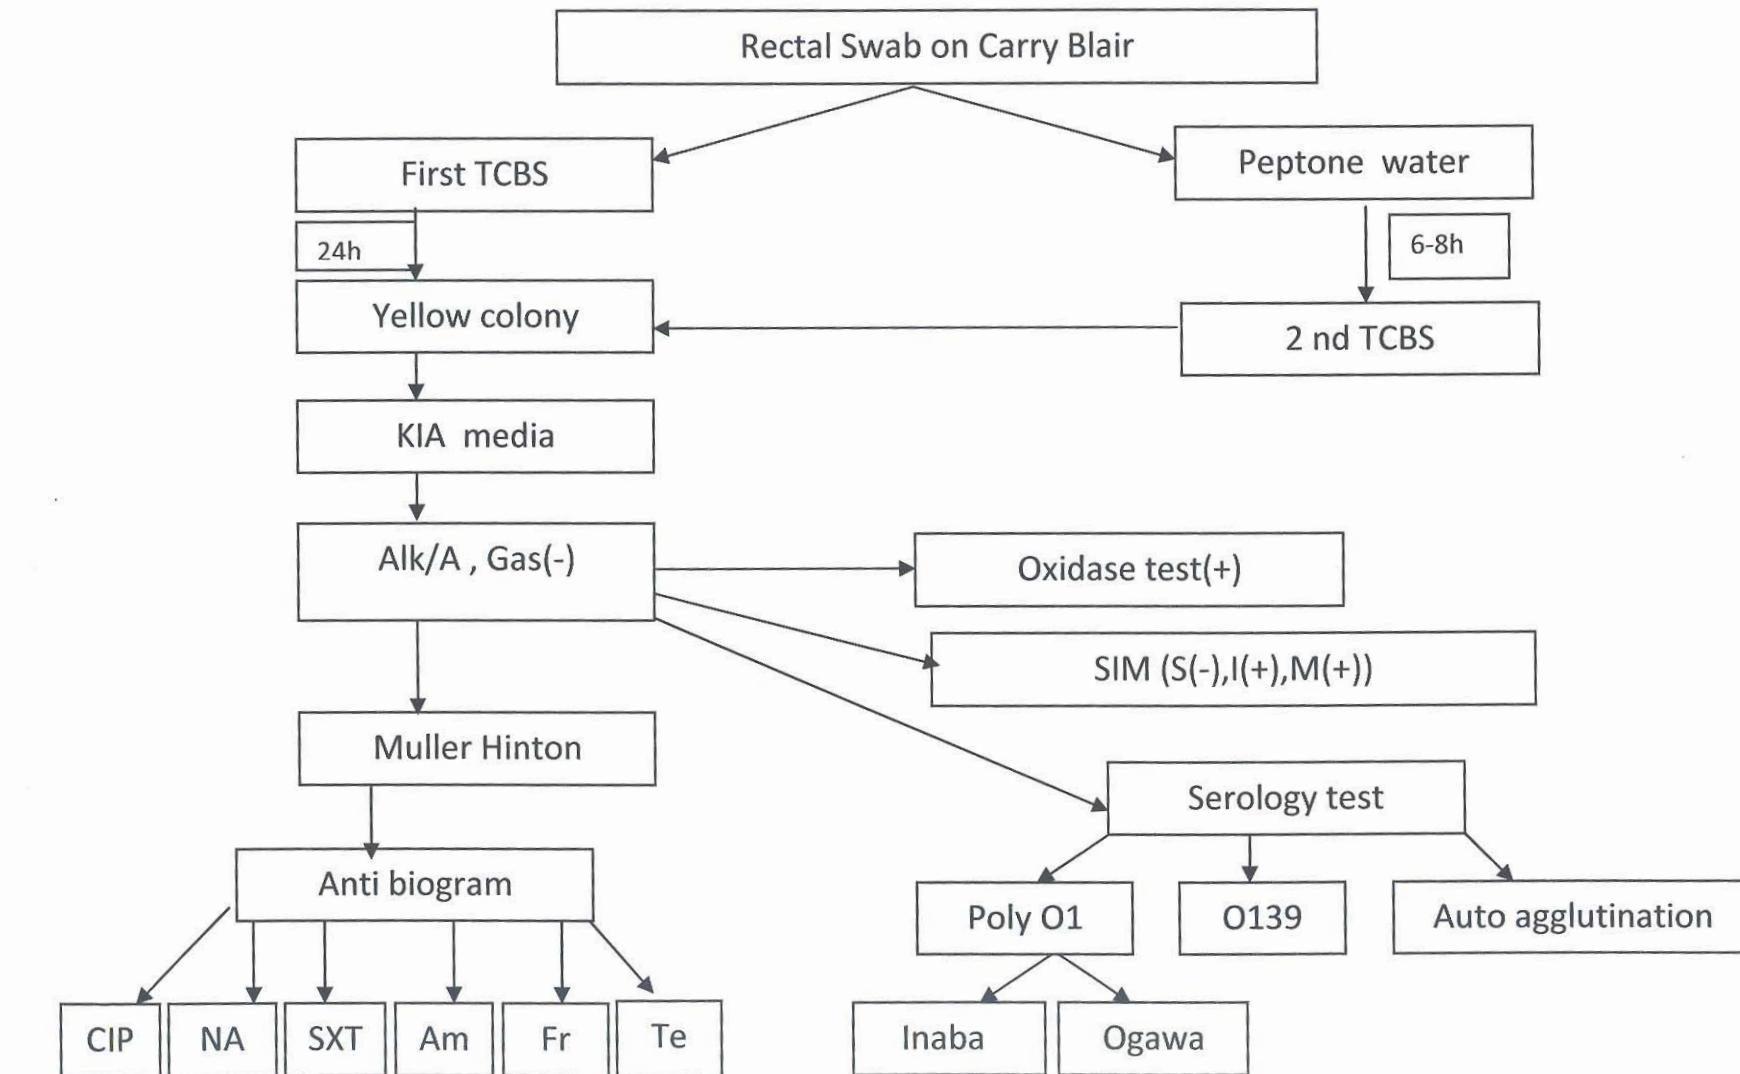

## مراحل ارجاع نمونه های مشکوک به کلرا جهت تأیید تشخیص

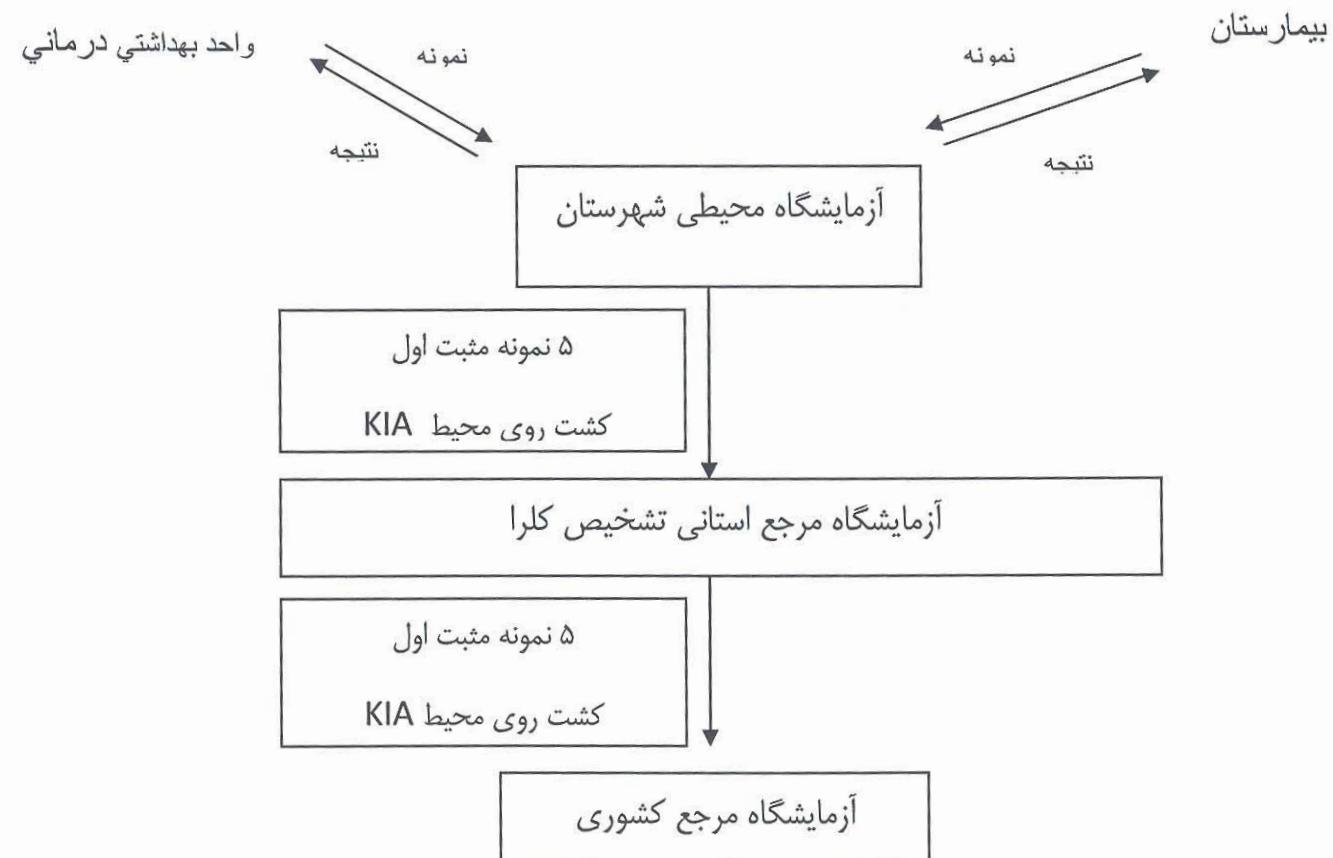

هر آزمایشگاه پس از تأیید ۵ نمونه توسط آزمایشگاه مرجع کشوری کلرا، اجازه گزارش تشخیصهای بعدی خود را دارد.

## فرم ثبت و نگهداری نتایج آزمایشات ویبریو کلرا در آزمایشگاه

نام آزمایشگاه

نام شهرستان .....

نام استان .....  
.....



## جدول برآورد تقریبی

### مقادیر محیط‌های کشت مورد نیاز در تشخیص آزمایشگاهی ویبریو کلرا

| ردیف | نام محیط        | مقدار پودر محیط در یک لیتر بر حسب گرم | حجم مورد نیاز پلیت/لوله بر حسب میلی لیتر | تعداد پلیت/لوله حاصله از یک لیتر محیط آماده | تعداد پلیت/لوله حاصله از نیم کیلوگرم پودر محیط تجاری |
|------|-----------------|---------------------------------------|--|---|--|
| ۱    | Carry Blair     | ۹۹۱/ml<br>۱۲/۶ gr                     | ۶ml/tube                                 | ۱۶۵Tube                                     | ۶۵۵-Tube   |
| ۲    | TCBS            | ۸۹                                    | ۲۵ml/plate                               | ۴-Plate                                     | ۲۳-Plate   |
| ۳    | APW             | ۲۵/۵                                  | ۲ml/tube                                 | ۵-Plate                                     | ۹۸۰-Tube   |
| ۴    | مولر هیتون آگار | ۳۸                                    | ۳۰ml/plate                               | ۳۳Plate                                     | ۴۴-Plate   |
| ۵    | KIA             | ۳۵                                    | ۵ml/tube                                 | ۲۰-Tube                                     | ۲۸۵-Tube   |
| ۶    | TSI             | ۶۵                                    | ۵ml/tube                                 | ۲۰-Tube                                     | ۱۵۴-Tube   |
| ۷    | SIM             | ۳۰                                    | ۵ml/tube                                 | ۲۰-Tube                                     | ۳۳۳-Tube   |

\* توجه: مقادیر فوق تقریبی بوده و فقط جهت تخمین مقدار محیط‌های کشت مورد نیاز ارائه گردیده است. لذا ضروری است جهت تهییه کلیه محیط‌های کشت حتماً به دستورالعمل روی محیط‌ها مراجعه شود.

آدرس: خیابان حافظ ، نرسیده به جمهوری ، کوچه زرتشتیان ، کوچه محمد بیک ، پلاک ۴۸ ، طبقه دوم ، آزمایشگاه مرجع سلامت

Tel : ۰۶۶۷۲۸۱۲۱ Fax : ۰۶۶۷۲۸۱۱۲